


現場で役に立つIGRA使用の手引きVer. 2

p11の訂正とお詫び

本文11pの3.1 QFTの判定基準の5行目の数値と図5内の数値に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。5行目と図5は以下のとおり読み替えをお願いします。

5行目 (誤) (>0.8 IU/ml) \Rightarrow (正) (>8.0 IU/ml)

図5 判定のフローチャート

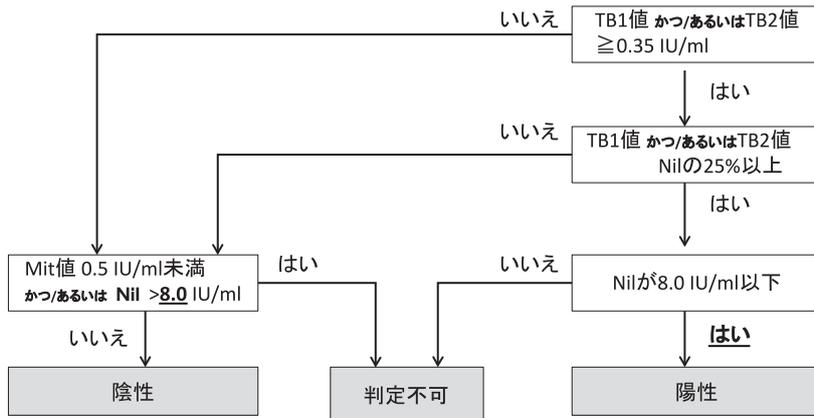

TB1値=TB1- Nil

TB2値=TB2- Nil

Mit値=Mitogen - Nil